HAYASHI DENKO

校正可能な温度範囲を拡大しました

−95～−40℃

取扱品目：測温抵抗体、熱電対

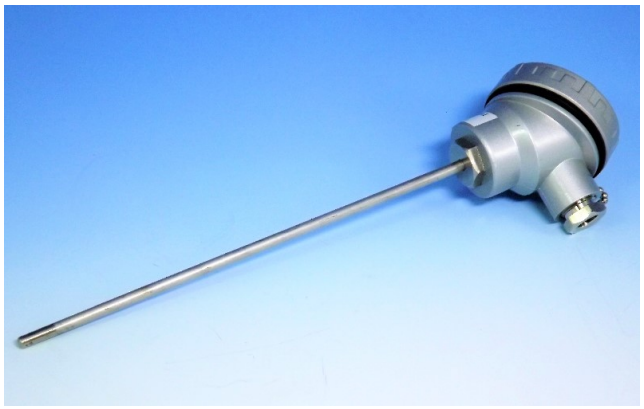

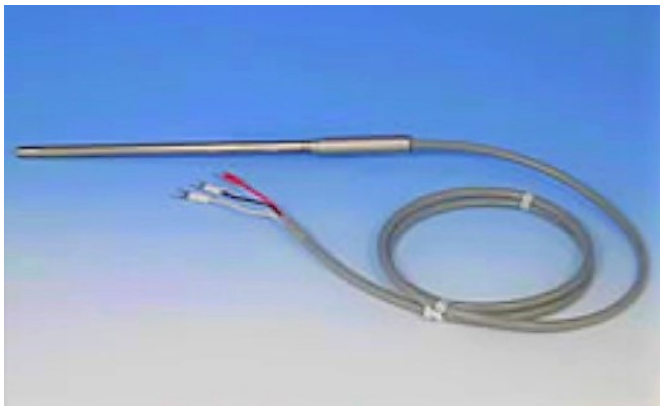

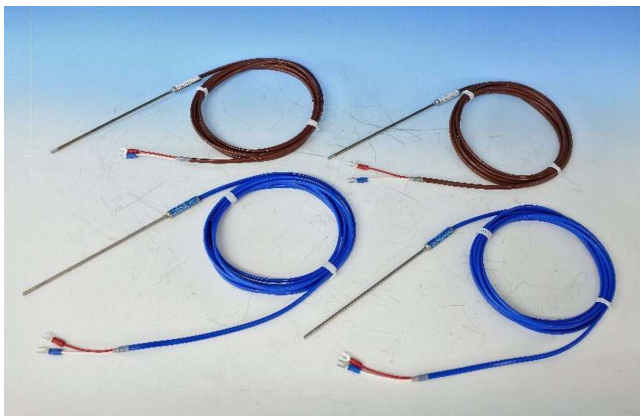

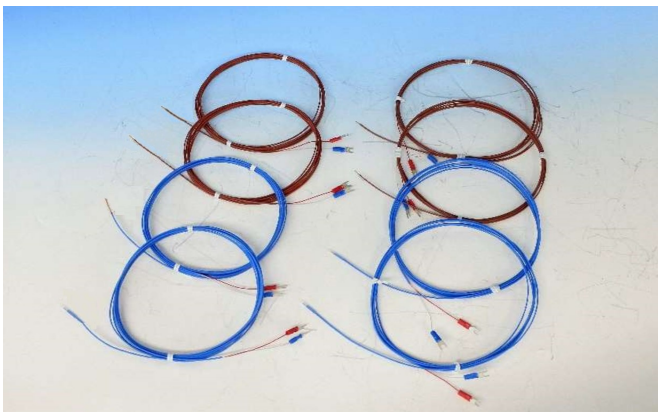

林電工の校正サービスの特長

1 任意の温度で校正可能

当社は-40～-95℃までの任意の温度で校正することが可能です。お客様のご希望の温度で校正した温度センサーをご提供致します。
※最高測定能力(信頼性水準95%)
　測温抵抗体：0.084℃,　熱電対：0.42℃

2 トレーサビリティ体系を確立

当社の参照標準としての標準計測器は計量法に基づく認定事業者にて定期的に校正されており、独立行政法人 産業技術総合研究所（AIST）・計量標準総合センター（NMIJ）の国家標準に対してトレーサビリティがとれております。

3 校正証明書を発行

製品の校正を実施したことを証明する校正証明書を発行することが可能です。お客様の安心・安全な品質管理の一助となるよう、ご要望に応じて校正証明書とトレーサビリティ体系図をご提供致します。

4 製品の再校正にも対応

当社の温度センサーをご購入頂く際はもちろん、
ご購入頂いた後の定期的な校正にも対応しています。
再校正をご依頼の際は営業担当までご連絡ください。

低温校正サービス

従来よりも幅広い温度範囲を、任意の温度で校正することが可能です。

校正可能な温度範囲

従来より低い温度範囲でも任意の温度で校正できるよう対応致しました。例えば-60℃や-80℃など、お客様が本当に必要な温度での校正をピンポイントに実施することが可能です。

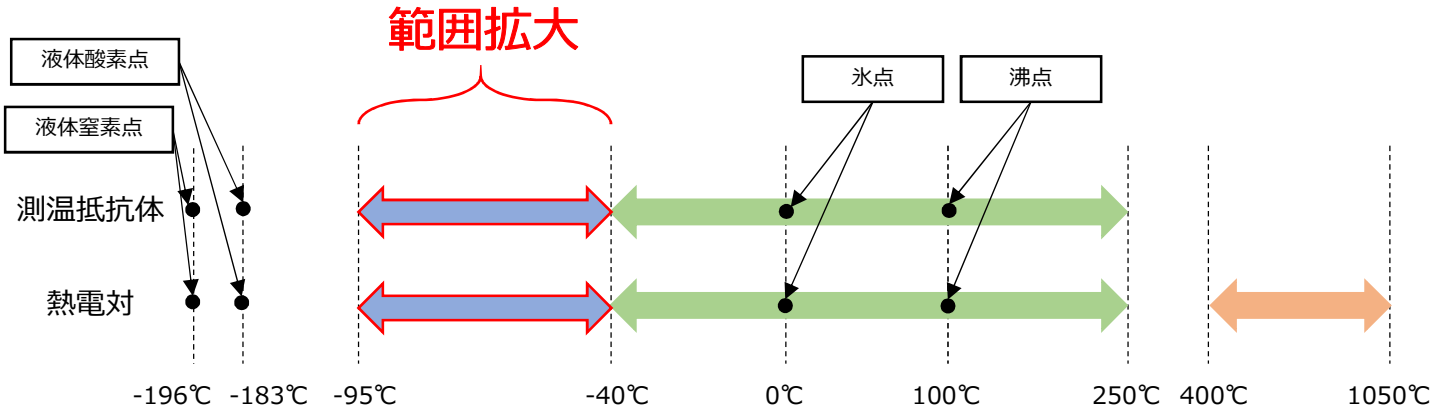

校正可能な形状

校正可能な代表的な形状を以下に記載します。この形状以外の形状で校正をご希望の場合は、当社営業担当にご相談ください。

①被覆熱電対（フッ素樹脂被覆）



②リード直結型測温抵抗体/熱電対

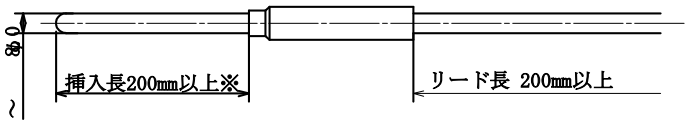

③端子箱付き測温抵抗体/熱電対

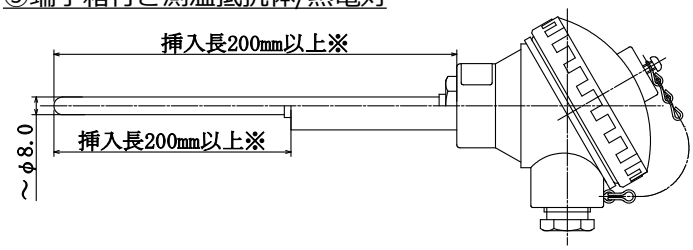

※保護管もしくはシースの中間にねじやフランジ等の部品がつく場合は挿入長280mm以上

⚠ ご注意

●校正可能な形状に制限がある為、形状によってはご要望に沿えない場合がございます。

●温度を測定する際は測定電流や自己加熱、外乱の影響など様々な要因から誤差が生じ、測定環境によっては最高測定能力を超える誤差が生じる場合があります。より正確な温度測定をご希望の場合は当社営業担当にご相談ください。

お問い合わせ先

林電工株式会社

HAYASHI DENKO URL http://www.hayashidenko.co.jp

本　　社　〒113-0021 東京都文京区本駒込6丁目5番5号
TEL 03-3945-3151㈹　FAX 03-3945-3130

静岡営業所　〒424-0044 静岡県静岡市清水区江尻台町16番3号
TEL 054-364-9460　FAX 054-367-4046

大阪営業所　〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-8-8 花原第8ビル
TEL 06-6885-4801　FAX 06-6885-4825